

**Polyflush Syringe SS**  
0.9% sodium chloride (0.9% NaCl)  
Single sterile (SS) = Sterile Fluid Path  
INSTRUCTIONS FOR USE

CE

0123

**MATERIALS USED**

Polyflush

Sodium Chloride

**INDICATION AND CLINICAL USE**

Prefilled Syringe with Saline solution is intended to be used only for flushing of indwelling vascular access devices (VAD's) for maintaining patency of VAD's.

**CONTRACTION**

None Known

**ADVERSE REACTION**

None Known

**DIRECTIONS FOR USE**

Use aseptic technique throughout the procedure.

1. Open the pack and remove syringe.

2. Visually inspect product for physical matter and ensure it is used according to Warning and Precautions.

3. Check that syringe tip cap is in place. Inspect the clarity of solution visually (Fig. 1a).

4. Depress the plunger to release the air bubbles (Fig. 1b).

5. Insert the tip from the side ensuring that there is no touch contamination of the syringe luer connection (Fig. 2).

6. Push syringe plunger to clear the air. Do not use device if not used within 24 hours (Fig. 3).

7. Connect Polyflush syringe to vascular access device taking care that there is no touch contamination of the connection (Fig. 4).

8. Push syringe plunger to flush the required volume of saline following institution's policy (Fig. 5). In case of extreme plunger resistance, it is recommended that excess force is not exerted.

9. After use, dispose of the syringe including any unused solution in accordance with institution's biohazardous waste policy or CDC guidelines for the same.

**WARNING**

1. Read carefully instructions for use before using the product.

2. The product should not be used only by qualified healthcare professionals.

3. Not to be used on Sterile Field.

4. Not to be used for injections as this is intended for flushing only.

5. Check the expiration date of product before use. Do not use if product is expired.

**DANGER**

Discard if plunger is damaged, as it indicates syringe leakage or rupture.

7. Do not use if packaging or product has been damaged or contaminated.

8. Use and store the contents of each prefilled syringe for presence of saline solution; clear content, particulate matter, precipitate, discoloration and leakage prior to use. Do not use if any of the aforementioned is observed.

9. Do not use if to be trapped in the syringe.

10. Do not re-sterilize. Discard the set after single use.


11. For single use in a single patient only. Re-use of single use devices creates a potential risk for patient or user.

12. Do not use if the device may lead to injury, illness or inflammation.

Poly Medicure Limited is responsible for any direct incidental damage resulting from reuse of product.

**STORAGE AND STABILITY**

Prefilled Syringe with 0.9% sodium chloride solution should be stored between 5°C and 25°C, protect from direct sunlight and freezing.

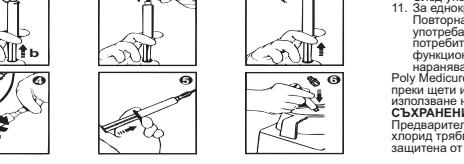

Cautions	See Instructions for use	REF Product reference/ Art. No.	For single use only
Do not Resterilize	Do not use if packaging or product has been damaged or contaminated	LOT	Date of Manufacturing
Use by / Expiry date	STERILE R Fluid Path Sterilized using irradiation	EC REP European Authorised Representative	Manufactured by
Fluid Path Non Pyrogenic	Storage Condition	Keep away from Sunlight	Keep Dry
		5°C - 25°C	

**Спринцовка Polyflush SS**  
0.9% натрий хлорид (0.9% NaCl)  
Единичен стерилен (SS) = Стерилен Fluid Path  
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

CE

0123

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛА**

Полиэтилен, стерильный, излучением стерилизован (SBR).

**ПОКАЗАНИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ**

Предназначена для промывания с физиологическим раствором, предотвращения застаивания сока из постостомии устройства для поддержания на проходимости канала для дренажа (VAD), с целю поддержания на проходимости канала для дренажа (VAD).

**КОНДИЦИОНАЦИЯ**

None Known

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

None Known

**АДВЕРСНЫЕ РЕАКЦИИ**

None Known

**ДИРЕКТИВЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

Use aseptic technique throughout the procedure.

1. Open the pack and remove syringe.

2. Visually inspect product for physical matter and ensure it is used according to Warning and Precautions.

3. Check that syringe tip cap is in place. Inspect the clarity of solution visually (Fig. 1a).

4. Depress the plunger to release the air bubbles (Fig. 1b).

5. Insert the tip from the side ensuring that there is no touch contamination of the syringe luer connection (Fig. 2).

6. Push syringe plunger to clear the air. Do not use device if not used within 24 hours (Fig. 3).

7. Connect Polyflush syringe to vascular access device taking care that there is no touch contamination of the connection (Fig. 4).

8. Push syringe plunger to flush the required volume of saline following institution's policy (Fig. 5). In case of extreme plunger resistance, it is recommended that excess force is not exerted.

9. After use, dispose of the syringe including any unused solution in accordance with institution's biohazardous waste policy or CDC guidelines for the same.

**ПОДСКАЗКА**

1. Read carefully instructions for use before using the product.

2. The product should not be used only by qualified healthcare professionals.

3. Not to be used on Sterile Field.

4. Not to be used for injections as this is intended for flushing only.

5. Check the expiration date of product before use. Do not use if product is expired.

**ПОДСКАЗКА**

Discard if plunger is damaged, as it indicates syringe leakage or rupture.

7. Do not use if packaging or product has been damaged or contaminated.

8. Use and store the contents of each prefilled syringe for presence of saline solution; clear content, particulate matter, precipitate, discoloration and leakage prior to use. Do not use if any of the aforementioned is observed.

9. Do not use if to be trapped in the syringe.

10. Do not re-sterilize. Discard the set after single use.

11. For single use in a single patient only. Re-use of single use devices creates a potential risk for patient or user.

12. Do not use if the device may lead to injury, illness or inflammation.

Poly Medicure Limited is responsible for any direct incidental damage resulting from reuse of product.

**ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ**

Prefilled Syringe with 0.9% sodium chloride solution should be stored between 5°C and 25°C, protect from direct sunlight and freezing.

**Проплачоваващ стъркачка Polyflush SS**  
0.9% натрий хлорид (0.9% NaCl)

CE

0123

**ИСПОЛЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛА**

Полиэтилен, стерильный, излучением стерилизован (SBR).

**ПОКАЗАНИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ**

Предназначена для промывания с физиологическим раствором, предотвращения застаивания сока из постостомии устройства для поддержания на проходимости канала для дренажа (VAD), с целю поддержания на проходимости канала для дренажа (VAD).

**КОНДИЦИОНАЦИЯ**

None Known

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

None Known

**АДВЕРСНЫЕ РЕАКЦИИ**

None Known

**ДИРЕКТИВЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

Use aseptic technique throughout the procedure.

1. Open the pack and remove syringe.

2. Visually inspect product for physical matter and ensure it is used according to Warning and Precautions.

3. Check that syringe tip cap is in place. Inspect the clarity of solution visually (Fig. 1a).

4. Depress the plunger to release the air bubbles (Fig. 1b).

5. Insert the tip from the side ensuring that there is no touch contamination of the syringe luer connection (Fig. 2).

6. Push syringe plunger to clear the air. Do not use device if not used within 24 hours (Fig. 3).

7. Connect Polyflush syringe to vascular access device taking care that there is no touch contamination of the connection (Fig. 4).

8. Push syringe plunger to flush the required volume of saline following institution's policy (Fig. 5). In case of extreme plunger resistance, it is recommended that excess force is not exerted.

9. After use, dispose of the syringe including any unused solution in accordance with institution's biohazardous waste policy or CDC guidelines for the same.

**ПОДСКАЗКА**

Discard if plunger is damaged, as it indicates syringe leakage or rupture.

7. Do not use if packaging or product has been damaged or contaminated.

8. Use and store the contents of each prefilled syringe for presence of saline solution; clear content, particulate matter, precipitate, discoloration and leakage prior to use. Do not use if any of the aforementioned is observed.

9. Do not use if to be trapped in the syringe.

10. Do not re-sterilize. Discard the set after single use.

11. For single use in a single patient only. Re-use of single use devices creates a potential risk for patient or user.

12. Do not use if the device may lead to injury, illness or inflammation.

Poly Medicure Limited is responsible for any direct incidental damage resulting from reuse of product.

**Полифлус-сприте SS**  
0.9% натрий хлорид (0.9% NaCl)

CE

0123

**ИСПОЛЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛА**

Полиэтилен, стерильный, излучением стерилизован (SBR).

**ПОКАЗАНИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ**

Предназначена для промывания с физиологическим раствором, предотвращения застаивания сока из постостомии устройства для поддержания на проходимости канала для дренажа (VAD), с целю поддержания на проходимости канала для дренажа (VAD).

**КОНДИЦИОНАЦИЯ**

None Known

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

None Known

**АДВЕРСНЫЕ РЕАКЦИИ**

None Known

**ДИРЕКТИВЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

Use aseptic technique throughout the procedure.

1. Open the pack and remove syringe.

2. Visually inspect product for physical matter and ensure it is used according to Warning and Precautions.

3. Check that syringe tip cap is in place. Inspect the clarity of solution visually (Fig. 1a).

4. Depress the plunger to release the air bubbles (Fig. 1b).

5. Insert the tip from the side ensuring that there is no touch contamination of the syringe luer connection (Fig. 2).

6. Push syringe plunger to clear the air. Do not use device if not used within 24 hours (Fig. 3).

7. Connect Polyflush syringe to vascular access device taking care that there is no touch contamination of the connection (Fig. 4).

8. Push syringe plunger to flush the required volume of saline following institution's policy (Fig. 5). In case of extreme plunger resistance, it is recommended that excess force is not exerted.

9. After use, dispose of the syringe including any unused solution in accordance with institution's biohazardous waste policy or CDC guidelines for the same.

**ПОДСКАЗКА**

Discard if plunger is damaged, as it indicates syringe leakage or rupture.

7. Do not use if packaging or product has been damaged or contaminated.

8. Use and store the contents of each prefilled syringe for presence of saline solution; clear content, particulate matter, precipitate, discoloration and leakage prior to use. Do not use if any

<b>Siringa Polyflush SS</b> 0,9% chlorid de sodiu (0,9% NaCl) Singula sterila (SS) = percorso del fluido sterile ISTRUZIONI PER L'USO	<b>Polyflush švirkštas SS</b> 0,9% natrio chlорidas (0,9% NaCl) Vienkartinis sterilius (SS) = steriles skysto kelias NAUDOTIMO INSTRUKCIJOS	<b>Polyflush šlirce SS</b> 0,9% natriumchlorid (0,9% NaCl) Singeri sterili (SS) = steriles skräckra geléjs NAUDOTIMO INSTRUKCIJA	<b>Injetiespuit Polyflush SS</b> 0,9% natriumchlorid (0,9% NaCl) Enkelt sterili (SS) = steril vloeistofspuit GEBRUIKSAANWIJZINGEN	<b>Polyflush sprøte SS</b> 0,9% natriumchlorid (0,9% NaCl) Enkelt sterili (SS) = steriles tekofluid spuit INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA	<b>Strzykawka Polyflush SS</b> 0,9% natriumchlorid (0,9% NaCl) Jedna sterili (SS) = cesta sterilne tekofluid INSTRUCOES DE UTILIZACAO	<b>Seringā Polyflush SS</b> 0,9% natrijum klorīds (0,9% NaCl) Singula sterila (SS) = Calea fluidului steril INSTRUȚIUNI CU PENTRU TECNICI	<b>Polyflush špric SS</b> 0,9% natrijum klorīds (0,9% NaCl) Enkelt sterili (SS) = steriles tekofluid spuit INSTRUCOES DE UTILIZACAO	<b>Brzga Polyflush SS</b> 0,9% natrijum klorīds (0,9% NaCl) Jedna sterili (SS) = cesta sterilne tekofluid NAVODLA ZA UPORABO
<b>MATERIALI UTILIZATI</b> Polypropylene SBR diaphragm de Soda	<b>NAUDOTIMO MEDŽIAGOS</b> Polipropileno SBR diaphragmo de Soda	<b>INDICAZIONI DI UTILIZZO CLINICO</b> Siringa pre-riempita con soluzione salina destinata unicamente al lavaggio del dispositivo di accesso vascolare (VAD) e permanenza per mantenere la pervietà del VAD.	<b>NAUDOTIMO MATERIALES</b> Polipropileno SBR diaphragma de Soda	<b>INDICACIONES Y CLÍNICA DE USO</b> Siringa pre-riempita con soluzione salina destinata unicamente al lavaggio del dispositivo di accesso vascolare (VAD) e permanenza per mantenere la pervietà del VAD.	<b>NAUDOTIMO MATERIALE</b> Polipropileno SBR diaphragma de Soda	<b>INDICACIONES Y CLÍNICA DE USO</b> Siringa pre-riempita con soluzione salina destinata unicamente al lavaggio del dispositivo di accesso vascolare (VAD) e permanenza per mantenere la pervietà del VAD.	<b>NAUDOTIMO MATERIALE</b> Polipropileno SBR diaphragma de Soda	<b>INDICACIONES Y CLÍNICA DE USO</b> Siringa pre-riempita con soluzione salina destinata unicamente al lavaggio del dispositivo di accesso vascolare (VAD) e permanenza per mantenere la pervietà del VAD.
<b>INDICAZIONI DI UTILIZZO CLINICO</b> Siringa pre-riempita con soluzione salina destinata unicamente al lavaggio del dispositivo di accesso vascolare (VAD) e permanenza per mantenere la pervietà del VAD.	<b>INDICACIONES Y CLÍNICA DE USO</b> Siringa pre-riempita con soluzione salina destinata unicamente al lavaggio del dispositivo di accesso vascolare (VAD) e permanenza per mantenere la pervietà del VAD.	<b>PRÉREQUISITES ET CONSIDÉRATIONS CLINIQUES</b> Siringa pré-remplie avec solution saline destinée uniquement au lavage du dispositif d'accès vasculaire (VAD) et permanence pour maintenir la pervieté du VAD.	<b>PRÉREQUISITES ET CONSIDÉRATIONS CLINIQUES</b> Siringa pré-remplie avec solution saline destinée uniquement au lavage du dispositif d'accès vasculaire (VAD) et permanence pour maintenir la pervieté du VAD.	<b>PRÉREQUISITES ET CONSIDÉRATIONS CLINIQUES</b> Siringa pré-remplie avec solution saline destinée uniquement au lavage du dispositif d'accès vasculaire (VAD) et permanence pour maintenir la pervieté du VAD.	<b>PRÉREQUISITES ET CONSIDÉRATIONS CLINIQUES</b> Siringa pré-remplie avec solution saline destinée uniquement au lavage du dispositif d'accès vasculaire (VAD) et permanence pour maintenir la pervieté du VAD.	<b>PRÉREQUISITES ET CONSIDÉRATIONS CLINIQUES</b> Siringa pré-remplie avec solution saline destinée uniquement au lavage du dispositif d'accès vasculaire (VAD) et permanence pour maintenir la pervieté du VAD.	<b>PRÉREQUISITES ET CONSIDÉRATIONS CLINIQUES</b> Siringa pré-remplie avec solution saline destinée uniquement au lavage du dispositif d'accès vasculaire (VAD) et permanence pour maintenir la pervieté du VAD.	<b>PRÉREQUISITES ET CONSIDÉRATIONS CLINIQUES</b> Siringa pré-remplie avec solution saline destinée uniquement au lavage del dispositivo de acceso vascular (VAD) e permanencia para mantener la pervietat del VAD.
<b>CONTRACCIONDI</b> NESSUNA	<b>CONTRAINDIKACIJAS</b> Nė vienkielis	<b>CONTRACCIONDI</b> NESSUNA	<b>CONTRAINDIKACIJAS</b> Nė vienkielis	<b>CONTRAINDIKACIJAS</b> Nė vienkielis				
<b>EFFECTI COLLATERALI</b> Non sono noti effetti collaterali quando il prodotto viene indicato.	<b>SAVINIMAS POVEIKIS</b> Gaminys naudojant pagal indikacijas šalinotinio poveikio neužregistruota.	<b>CONTRACCIONDI</b> NESSUNA	<b>SAVINIMAS POVEIKIS</b> Gaminys naudojant pagal indikacijas šalinotinio poveikio neužregistruota.	<b>CONTRAINDIKACIJAS</b> Nė vienkielis	<b>CONTRAINDIKACIJAS</b> Nė vienkielis	<b>CONTRAINDIKACIJAS</b> Nė vienkielis	<b>CONTRAINDIKACIJAS</b> Nė vienkielis	<b>CONTRAINDIKACIJAS</b> Nė vienkielis
<b>ISTRUZIONI D'USO</b> Attenersi ad ogni procedura aseptica per tutta la durata della procedura.	<b>INDICAZIONI DI UTILIZZO CLINICO</b> Siringa pre-riempita con soluzione salina destinata unicamente al lavaggio del dispositivo di accesso vascolare (VAD) e permanenza per mantenere la pervietà del VAD.	<b>INDICACIONES Y CLÍNICA DE USO</b> Siringa pre-riempita con soluzione salina destinata unicamente al lavaggio del dispositivo di accesso vascolare (VAD) e permanenza per mantenere la pervietà del VAD.	<b>INDICACIONES Y CLÍNICA DE USO</b> Siringa pre-riempita con soluzione salina destinata unicamente al lavaggio del dispositivo di accesso vascolare (VAD) e permanenza per mantenere la pervietà del VAD.	<b>INDICACIONES Y CLÍNICA DE USO</b> Siringa pre-riempita con soluzione salina destinata unicamente al lavaggio del dispositivo di accesso vascolare (VAD) e permanenza per mantenere la pervietà del VAD.	<b>INDICACIONES Y CLÍNICA DE USO</b> Siringa pre-riempita con soluzione salina destinata unicamente al lavaggio del dispositivo di accesso vascolare (VAD) e permanenza per mantenere la pervietà del VAD.	<b>INDICACIONES Y CLÍNICA DE USO</b> Siringa pre-riempita con soluzione salina destinata unicamente al lavaggio del dispositivo di accesso vascolare (VAD) e permanenza per mantenere la pervietà del VAD.	<b>INDICACIONES Y CLÍNICA DE USO</b> Siringa pre-riempita con soluzione salina destinata unicamente al lavaggio del dispositivo di accesso vascolare (VAD) e permanenza per mantenere la pervietà del VAD.	<b>INDICACIONES Y CLÍNICA DE USO</b> Siringa pre-riempita con soluzione salina destinata unicamente al lavaggio del dispositivo di acceso vascular (VAD) e permanencia para mantener la pervietat del VAD.
<b>1. Attivarsi e proteggere le siringe.</b>	<b>2. Prima dell'utilizzo ispezionare visivamente il prodotto per verificare che non presenti polveri sottili e scolorimenti, conformemente alla sezione Avvertenze e Precauzioni.</b>	<b>3. Controllare che il cappuccio della punta della siringa sia correttamente fissato. Verificare visivamente che la somma sia intatta (Fig. 1).</b>	<b>4. Premere lo stantuffo con il cappuccio della punta per rilasciare il sigillo del tappo (Fig. 1b).</b>	<b>5. Svitare il cappuccio della punta dalla siringa assicurandosi di non contorcere la siringa (Fig. 2).</b>	<b>6. Premere lo stantuffo della siringa per espellere l'aria. Non utilizzare il dispositivo se non si rileva alcuna soluzione durante l'espulsione dell'aria (Fig. 3).</b>	<b>7. Collegare la siringa polyflush al dispositivo di accesso vascolare. Non utilizzare attenzione da non contaminare per contatto il dispositivo (Fig. 4).</b>	<b>8. Premere lo stantuffo della siringa per far fluire il volume richiesto di soluzione salina come da protocollo operatore (Fig. 5). In caso di estrema resistenza dello stantuffo si raccomanda di non contorcere la siringa per una forza eccessiva.</b>	<b>9. Dopo aver utilizzato la siringa, tenere la siringa per eventuali soluzioni da connettere al dispositivo per il smaltimento dei rifiuti biologici.</b>
<b>AFFERENTI E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>AFFERENTI E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>AFFERENTI E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>AFFERENTI E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>AFFERENTI E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>AFFERENTI E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>AFFERENTI E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>AFFERENTI E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>AFFERENTI E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.
<b>ATTENZIONE E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>ATTENZIONE E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>ATTENZIONE E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>ATTENZIONE E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>ATTENZIONE E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>ATTENZIONE E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>ATTENZIONE E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>ATTENZIONE E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>ATTENZIONE E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.
<b>AVVERTENZE E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>AVVERTENZE E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>AVVERTENZE E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>AVVERTENZE E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>AVVERTENZE E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>AVVERTENZE E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>AVVERTENZE E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>AVVERTENZE E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.	<b>AVVERTENZE E PRECAUZIONI</b> 1. Usare con attenzione le istruzioni d'uso prima di adoperare il prodotto.
<b>NON RISTERNERILIZZARE</b> Non utilizzare se il prodotto è stato danneggiato o contaminato.	<b>NON RISTERNERILIZZARE</b> Non utilizzare se il prodotto è stato danneggiato o contaminato.	<b>NON RISTERNERILIZZARE</b> Non utilizzare se il prodotto è stato danneggiato o contaminato.	<b>NON RISTERNERILIZZARE</b> Non utilizzare se il prodotto è stato danneggiato o contaminato.	<b>NON RISTERNERILIZZARE</b> Non utilizzare se il prodotto è stato danneggiato o contaminato.	<b>NON RISTERNERILIZZARE</b> Non utilizzare se il prodotto è stato danneggiato o contaminato.	<b>NON RISTERNERILIZZARE</b> Non utilizzare se il prodotto è stato danneggiato o contaminato.	<b>NON RISTERNERILIZZARE</b> Non utilizzare se il prodotto è stato danneggiato o contaminato.	<b>NON RISTERNERILIZZARE</b> Non utilizzare se il prodotto è stato danneggiato o contaminato.
<b>UTILIZZA ENTRA / Data di scadenza</b> Utilizza entro / Data di scadenza	<b>STERILE / R</b> Percorso del fluido sterilizzato mediante irradiazione	<b>EC REP</b> Rappresentante Europeo Autorizzato	<b>EC REP</b> Rappresentante Europeo Autorizzato	<b>STERILE / R</b> Percorso del fluido sterilizzato mediante irradiazione	<b>EC REP</b> Rappresentante Europeo Autorizzato	<b>STERILE / R</b> Percorso del fluido sterilizzato mediante irradiazione	<b>EC REP</b> Rappresentante Europeo Autorizzato	<b>STERILE / R</b> Percorso del fluido sterilizzato mediante irradiazione
<b>Perco</b> Perco	<b>25°C</b> Condizioni di conservazione	<b>25°C</b> Cambiare al riparo dalla luce del sole	<b>25°C</b> Conservare in luogo asciutto	<b>25°C</b> Cambiare al riparo dalla luce del sole	<b>25°C</b> Conservare in luogo asciutto	<b>25°C</b> Cambiare al riparo dalla luce del sole	<b>25°C</b> Conservare in luogo asciutto	<b>25°C</b> Cambiare al riparo dalla luce del sole
<b>POLY MEDICURE LTD.</b> Plot No. 34, Sector 68, IMT, Faridabad, Haryana-121004, India, Customer care no.: +91-129-4287053, Email: customercare@polymedure.com, Web: www.polymedure.com	<b>EC REP</b> Obelis S.a Boulevard Général Wahis 53,1030 Brussels, BELGIUM, Tel: +(32) 2. 732.59.54, E-mail : mail@obelis.net							